INSTRUKCJA OBSŁUGI
LINKI REHABILITACYJNYCH

SN	MD				CE	UDI
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

1. Budowa i zastosowanie

Linki rehabilitacyjne wykonane z linki nierozciągliwej bądź gumy i słabym lub mocnym oporze. Przeznaczone są do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu oraz zajęć kinezyterapeutycznych. Stanowią idealne wyposażenie kabiny UGUL PUR oraz urządzenia SLING.

2. Uwagi eksploatacyjne

a) Przed wykonaniem podwieszeń należy sprawdzić, czy element przeznaczony do zamocowania nie jest uszkodzony.

3. Zalecenia

a) Użytkować wyrób zgodnie z instrukcją obsługi,
b) Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

MODELE:

Linka 60cm ST4	
Linka 30cm ST5	
Linka elastyczna 60cm (słaby opór) ST6	
Linka elastyczna 60cm (mocny opór) ST7	
Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 120cm L1	
Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 160cm L2	
Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem - 350cm L3	
Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225cm L4	
Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem - 550 cm L5	

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.

4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w wypadku, gdy:
a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.

5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

6. Pojęcie „naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

8. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.

9. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.

10. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską, obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.

11. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.

12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

…….. …….. ……..
Data sprzedaży Pieczątka punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI
LINKI REHABILITACYJNE

Modele: Linka 60cm ST4; Linka 30cm ST5; Linka elastyczna 60cm (słaby opór) ST6; Linka elastyczna 60cm (mocny opór) ST7 ; Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 120cm L1; Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 160cm L2; Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem - 350cm L3; Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225cm L4; Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem - 550 cm L5

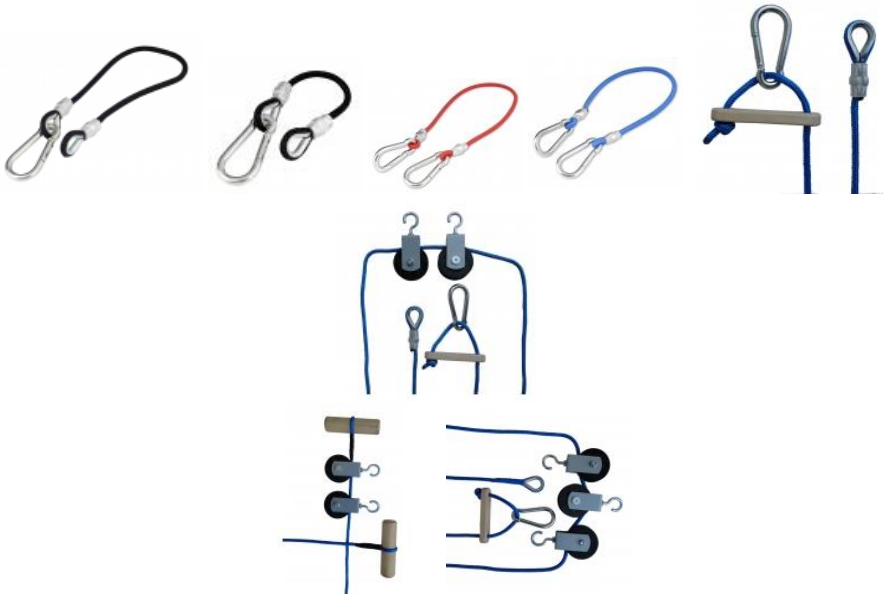

Wytwórca:
KINESIS Sp. z o.o.
ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45

Wydanie 03/2024, z dnia 4.12.2024